

第10回 **ヘルスケア・医療機器 開発展 大阪** **MEDIX** 出展のご案内
メディックス
OSAKA

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社はインテックス大阪で開催されます『第10回ヘルスケア・医療機器 開発展』に出展する運びとなりました。
ご多忙中誠に恐縮に存じますが、皆様お誘いあわせの上、弊社ブースへお立ち寄り頂きたくご案内申し上げます。

敬具

会期：2020年2月26日[水]～28日[金] 10:00～18:00 [最終日28日のみ17:00終了]

会場：インテックス大阪 弊社ブース：5号館 小間 No.12-48

弊社ブースの
見どころ

医療用コネクタの誤接続防止を目的にISO80369シリーズが新たに制定されました。
第一測範製作所は国内で唯一、ISO80369規格に対応したリファレンスコネクタを製作！
創業以来76年間ゲージを造り続けてきた確かな技術力で、品質と精度を保証します。
是非実物をお手に取ってご覧ください。

出展品


◆注射器 / 医療器 検査用コネクタ 及び 検査用ゲージ

ISO594-1, ISO594-2 が ISO80369 シリーズに代わります。移行準備はお済ですか？




国内でISO80369に対応したリファレンスコネクタを製作しているのは《第一測範製作所》だけ。
ゲージ製作で培ったノウハウでお客様にあった検査方法を提案。

◆麻酔及び呼吸機器 円錐コネクタ・ソケット試験用ゲージ

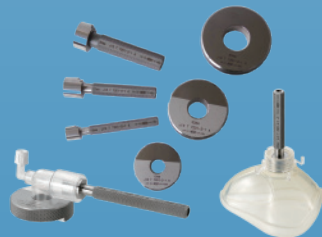

ISO5356-1(JIS T 7201-1)に基づいたゲージで、テーパ部の合否判定に使用。各器具の製造や検査工程、医療機関の受け入れ検査に使用されています。高度なラッピング技術を施したテーパゲージが、連結する医療器具の品質と精度を保証します。

◆粒度ゲージ（グラインドゲージ）

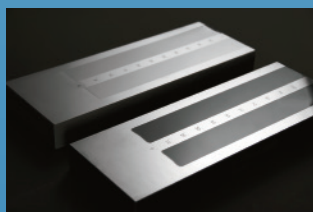

医療品、化粧品、食品等の粉体混練製品の分散性測定が可能。
職人による手作業でのラッピング加工で、判定にバラツキのない高精度な測定を実現。
溝深さは0～15μm、0～25μm、0～50μm、0～100μm。
この他にもお客様のニーズに応じたオーダーメイドが可能です。

《出展社による製品・技術セミナー》

出展社による製品・技術セミナーを行います。是非ご聴講下さい。

テーマ：ISO80369規格製品の検査にプラス。

内容：ISO80369に対応した医療器・注射器の内径 / 外径を検査するゲージ、角度を検査するゲージなど、
弊社独自の検査方法をご提案

株式会社 第一測範製作所



URL <https://www.issoku.jp>
E-mail info@issoku.jp




HP QRコード


本社・工場 新潟県小千谷市 TEL 0258-84-3911 FAX 0258-81-2113
大阪営業所 大阪市西区西本町 TEL 06-6533-3296 FAX 06-6537-2030

〈その他国内営業所〉本社、東京、名古屋、大阪、北陸、ボールねじ事業部、海外営業課
〈海外子会社〉上海、タイ

《インテックス大阪》

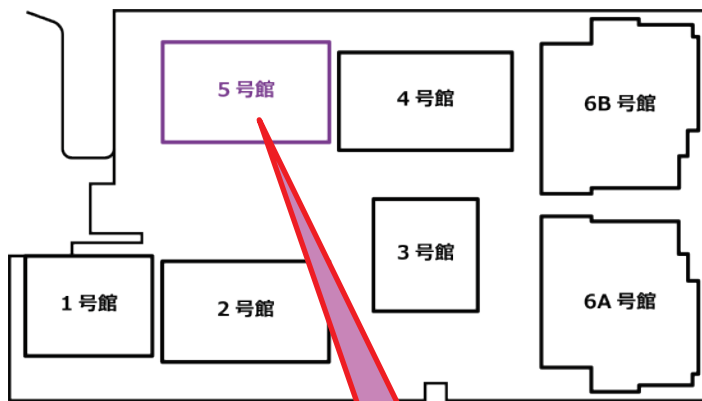

5号館

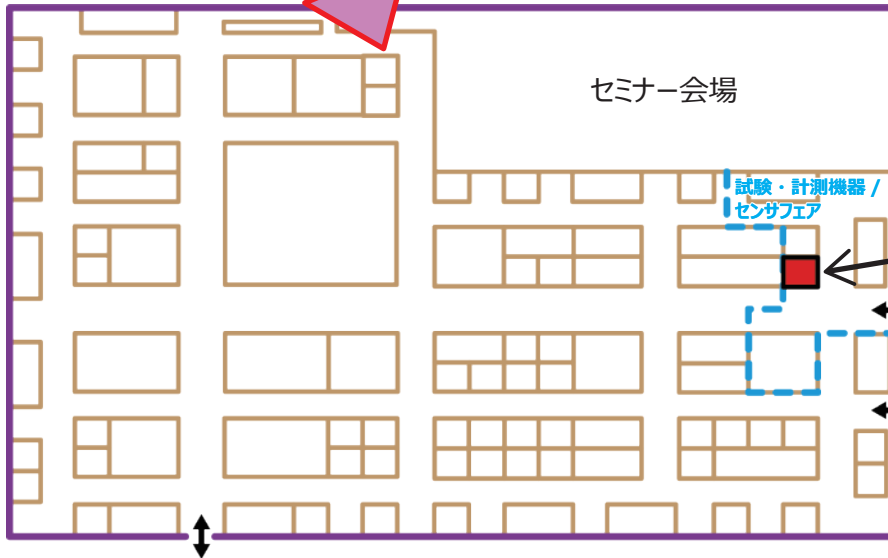

株式会社 **第一測範製作所**
5号館
小間番号：12-48

***** アポイントメントシート *****

★弊社ブースへご来場いただく日時、ご相談内容を事前にご連絡いただくと、お客様のご相談内容にあった資料をご用意いたします。ぜひ、下記シートに必要事項をご記入のうえ E-mail または FAX にてご連絡下さい。

・来場日時： _____ 月 _____ 日 _____ 午前 ・ 午後 _____ 時

・貴社名： _____

・所属・役職： _____

・お名前： _____

・当日ご連絡のとれるご連絡先： _____

・E-mail： _____

・ご相談内容：

★返送先

E-mail： y-takeishi@issoku.jp (営業部営業推進グループ 竹石)

FAX： 0258-81-2113